

## DG85 微差圧計のリニューアルについて

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

DG85 微差圧計のリニューアルについてご連絡致しますので、ご査収の程、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

### 記

DG85 微差圧計について、以下の通りリニューアルを行いますのでお知らせ致します。

- 対象機種 :  
DG85 微差圧計 全機種
- リニューアル内容  
リニューアル内容をまとめたものを表1に示します。


表1. 現状品/リニューアル品 仕様比較表

リニューアル項目		現状品	リニューアル品	
外枠	材質	金属(アルミニウム)製	樹脂(ポリアセタール)製	
	その他	デザイン変更(次頁 図1 参照)		
目盛様式 (次頁 図2 参照)	文字高さ	目盛数字	4mm	6mm
		単位	3.5mm	5mm
	サークル線	有	無	
	モデルNo.	表示無	4桁表示	
	器番	刻印(着色無)	黒色印刷	


- オーダー受付開始時期 :  
2019年3月15日より受付を開始致します。
- 現状品のオーダー受付について  
現状品のご要求については2020年3月まで対応致します。その後、現状品は廃止となります。
- 現状品の識別について  
現状品については製品小箱ラベルの右側に『○』を印字して識別致します。
- その他  
ご不明な点がございましたら、最寄りの弊社営業所または販売店までお問合せください。

以 上

参考資料1 外枠デザイン  
現状品

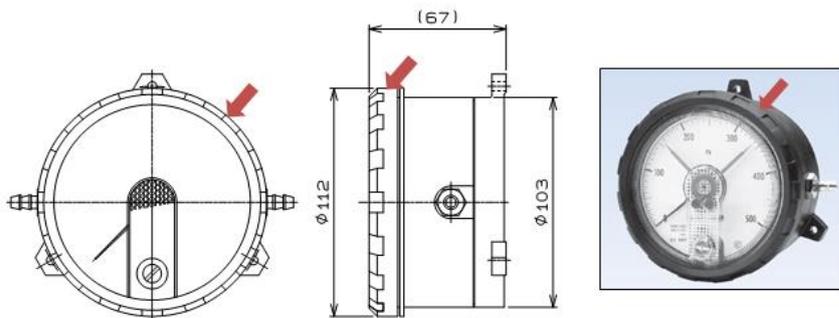

リニューアル品

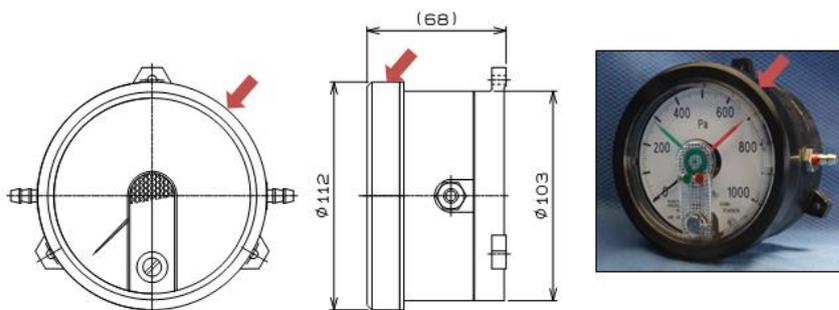

※矢印で示す部分が外枠になります。

図1 外枠変更

参考資料2 目盛様式

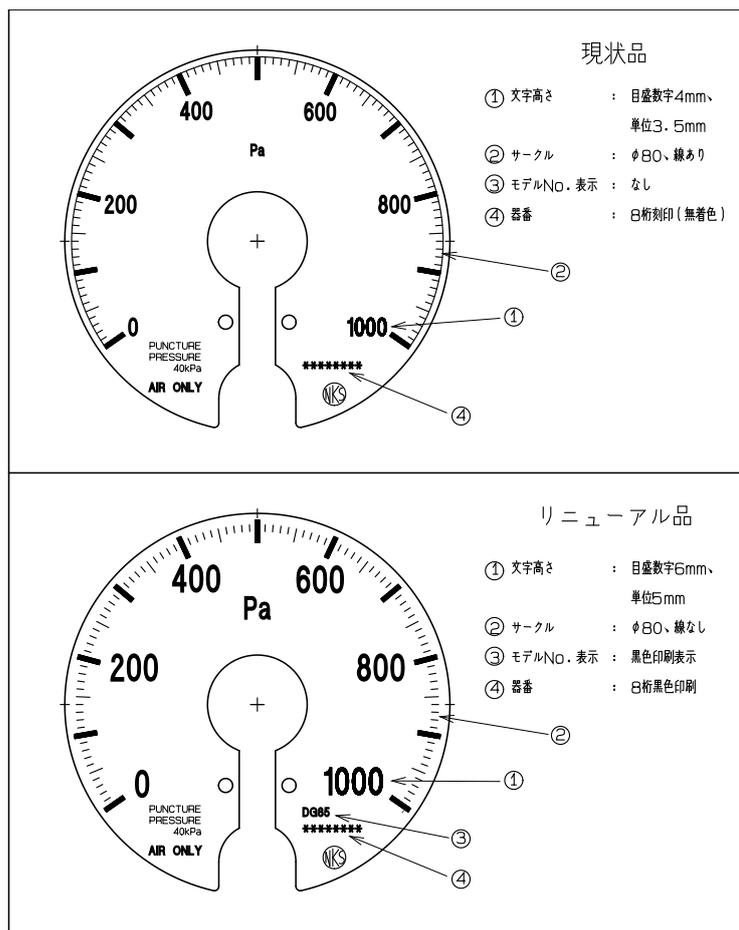


図2 目盛様式